

校准证书

客 户 名 称 广州瑞领医药有限公司

联 络 信 息 广东省广州市

样 品 名 称 立式超低温保存箱

型 号 / 规 格 DW-86L210

出 厂 编 号 JS241022H4008

设备编号: /

制 造 单 位 杭州冰星制冷电器有限公司

接 收 日 期 2025 年 08 月 04 日

校 准 日 期 2025 年 08 月 04 日

联系方式:

王经理

电话: 18002157309 (微信)

邮箱: 18002157309@163.com

陈经理

电话: 18622703793 (微信)

邮箱: 18622703793@163.com



扫描二维码
自助下单



关注我们
了解更多详情



中检西南计量有限公司

校准证书



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8200

证书编号: 9025218286



客户名称 广州瑞领医药有限公司

联络信息 广东省广州市

样品名称 立式超低温保存箱

型号 / 规格 DW-86L210

出厂编号 JS241022H4008 设备编号: /

制造单位 杭州冰星制冷电器有限公司

接收日期 2025 年 08 月 04 日

校准日期 2025 年 08 月 04 日



批准人 朱玉平 朱玉平

核验员 宋晗瑞 宋晗瑞

校准员 国泽峰 国泽峰

发布日期: 2025 年 08 月 04 日

地址: 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经牛路3号
联系电话: 0871-64105422 传真: 0871-64577518
监督电话: 0871-64636302 邮编: 650217
网址: <http://www.ynccttc.com> 电子邮件: kfzx@ynccttc.com



扫一扫查真伪



中检西南计量有限公司



证书编号: 9025218286

1. 我公司仅对加盖“中检西南计量有限公司校准专用章”的完整证书负责。
2. 未经本实验室书面批准, 不得部分复制本证书。
3. 本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效, 如有疑问请在15个工作日内反馈。
4. “委托方”、“联络信息”由委托方提供, “型号/规格”、“出厂编号(或设备编号)”以及“制造单位”为仪器上标注。
5. 本证书中给出的扩展不确定度依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》评定, 由合成标准不确定度乘以包含概率约为95%时对应的包含因子k得到。
6. 本次校准项目/参数的详细认可范围请查看CNAS网站中注册编号L8200的证书附件, 超出范围的内容未被认可。

校准环境条件及地点:

温度: 21.0 °C

地点: 现场_该医院外科楼14层

湿度: 46 %RH

其他: 保定市第二医院

本次校准所依据/参照的技术文件(代号、名称):

JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》

本次校准所使用的计量标准装置、主要计量器具/标准物质

名称	编号	测量范围	不确定度或准确度等级 或最大允许误差	溯源机构 及证书号	有效期至
温度巡检仪	220722178	(-80~300)°C	$U=0.10^{\circ}\text{C}, k=2$	中检西南计量有限公司 9021050085-003	2026-07-06


溯源性: 本次校准使用的计量标准器具均可溯源至国家计量基准/测量标准和国际单位制(SI)。

其他说明: /



校准数据/结果

1、传感器布点示意图

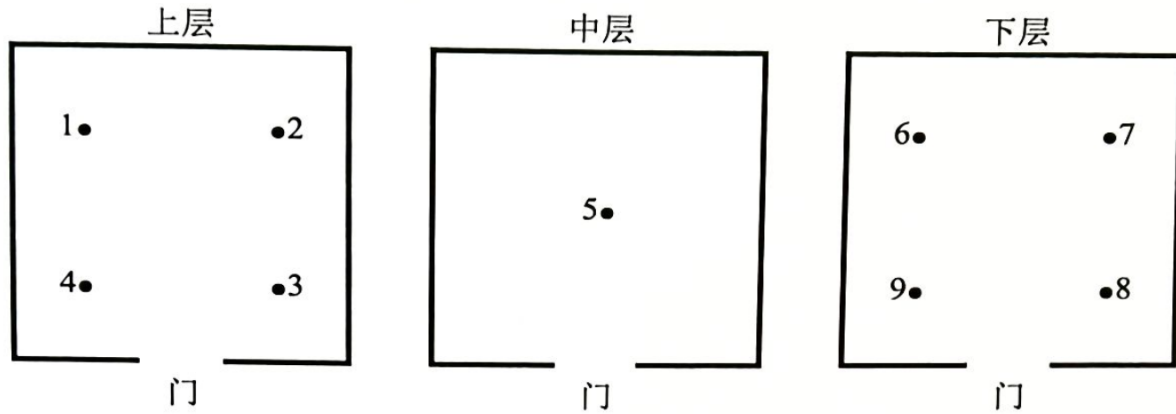

2、温度参数校准 (单位: °C)

校准点	上偏差	下偏差	均匀度	波动度	$U(k=2)$
-80	0.05	-0.14	0.08	± 0.09	0.38

所校项目符合规范参考技术要求

建议复校时间间隔12个月

~以下空白~

